


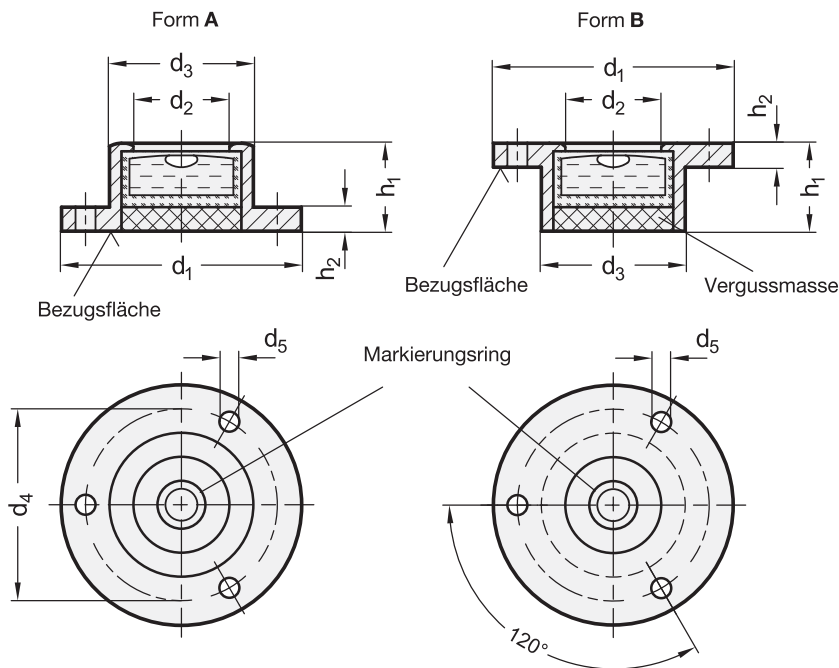

- 4 Empfindlichkeit**
30 Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
- 5 Form**
A Befestigungsflansch zum Aufsetzen
B Befestigungsflansch zum Einlassen (Bund)

2

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂
20	10	14	17	1,8	10	1,8
25	12	17	21	2,2	10	2
30	12	18	24	3,2	11	3
40	20	28	34,5	3,2	14	4
50	25	34	43	3,2	15	5

Ausführung

- Gehäuse
Aluminium
eloxiert, naturfarben **ALN**
eloxiert, schwarz **ALS**
- Libelleneinsatz
Glas-Kunststoffkörper
Füllung
farblos-transparent **K**
- Vergussmasse
mineralisch
- RoHS

Auf Anfrage

- Füllung, grün-transparent
- andere Empfindlichkeiten
- Messing- oder Edelstahl-Gehäuse

Hinweis

Dosenlibellen GN 2277 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen sind zur Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Dosen- und Längslibellen → Seite 309
- Justierplatten GN 2277.1 (für Dosenlibellen GN 2277) → Seite 312

Bestellbeispiel

GN 2277-ALS-50-K-30-A

1	Werkstoff / Oberfläche
2	d₁
3	Füllung
4	Empfindlichkeit
5	Form